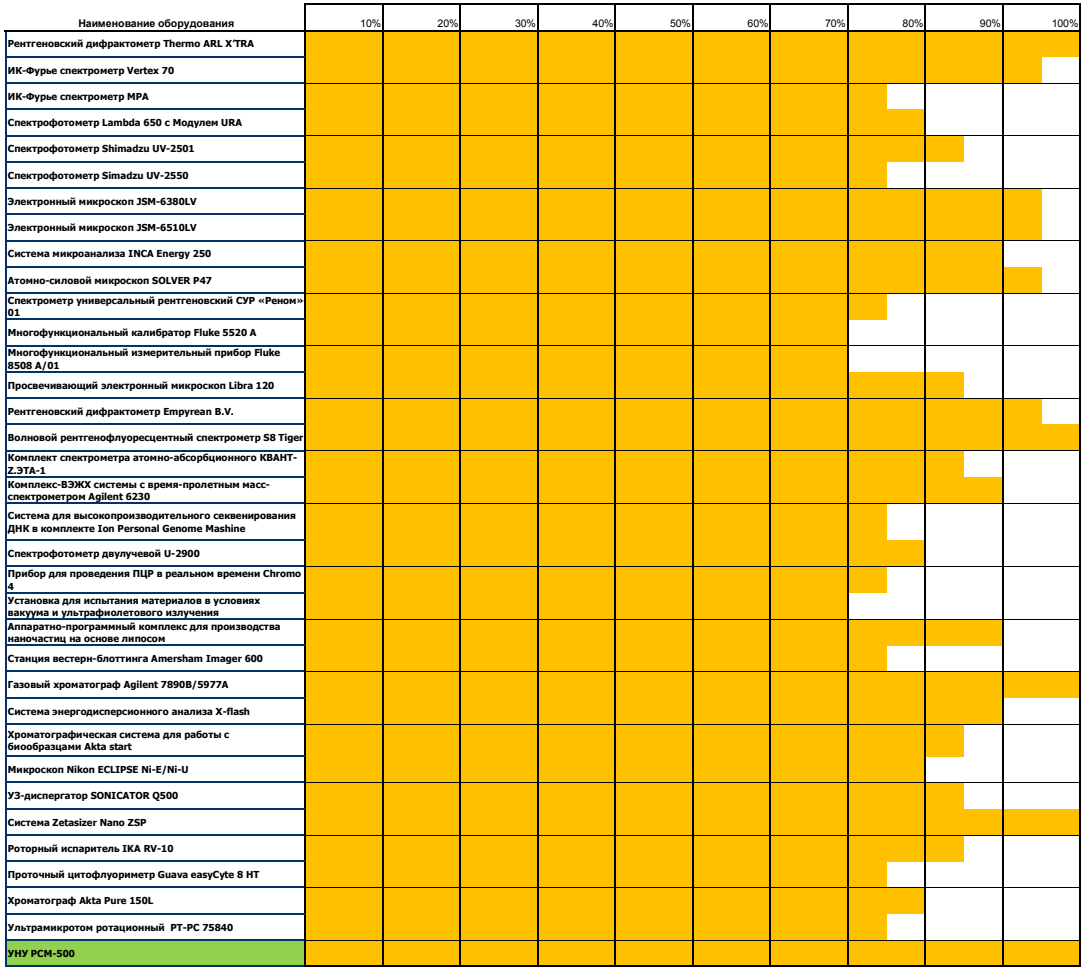
Наименование оборудования
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Рентгеновский дифрактометр Thermo ARL X'TRA
ИК-Фурье спектрометр Vertex 70
ИК-Фурье спектрометр MPA
Спектрофотометр Lambda 650 с Модулем URA
Спектрофотометр Shimadzu UV-2501
Спектрофотометр Simadzu UV-2550
Электронный микроскоп JSM-6380LV
Электронный микроскоп JSM-6510LV
Система микроанализа INCA Energy 250
Атомно-силовой микроскоп SOLVER P47
Спектрометр универсальный рентгеновский СУР «Реном» 01
Многофункциональный калибратор Fluke 5520 A
Многофункциональный измерительный прибор Fluke 8508 A/01
Просвечивающий электронный микроскоп Libra 120
Рентгеновский дифрактометр Empyrean B.V.
Волновой рентгенофлуоресцентный спектрометр S8 Tiger
Комплект спектрометра атомно-абсорбционного КВАНТ-Z.ЭТА-1
Комплекс-ВЭЖХ системы с время-пролетным масс-спектрометром Agilent 6230
Система для высокопроизводительного секвенирования ДНК в комплекте Ion Personal Genome Mashine
Спектрофотометр двулучевой U-2900
Прибор для проведения ПЦР в реальном времени Chromo 4
Установка для испытания материалов в условиях вакуума и ультрафиолетового излучения
Аппаратно-программный комплекс для производства наночастиц на основе липосом
Станция вестерн-блоттинга Amersham Imager 600
Газовый хроматограф Agilent 7890B/5977A
Система энергодисперсионного анализа X-flash
Хроматографическая система для работы с биообразцами Akta start
Микроскоп Nikon ECLIPSE Ni-E/Ni-U
УЗ-диспергатор SONICATOR Q500
Система Zetasizer Nano ZSP
Роторный испаритель IKA RV-10
Проточный цитофлуориметр Guava easyCyte 8 HT
Хроматограф Akta Pure 150L
Ультрамикротом ротационный PT-PC 75840
УНУ РСМ-500